



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN
RSUP dr. SOERADJI TIRTONEGORO

Jalan dr. KRT. Soeradji Tirtonegoro Nomor 1 Klaten
Telepon:(0272)321020 (Hunting) Faximile:(0272)321104 E-mail: rsupsoeradji_klaten@yahoo.com



BERITA ACARA PEMBERIAN PENJELASAN

**KERJASAMA ALAT PEMBACAAN STRIP URIN ANALISA
DAN ALAT PEMBACAAN SEDIMEN URIN OTOMATIS
INSTALASI LABORATORIUM**


Nomor: KN.01.05/XII.1.BLU/22627/2021
Tanggal : 30 Desember 2021

Pada hari ini Kamis, tanggal tiga puluh bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini Tim KSO ULP, Tim Teknis, dan Tim Kerjasama Bidang Pelayanan RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten telah mengadakan Penjelasan Dokumen Pemilihan Nomor KN.01.05/XII.1.BLU/22329/2021 Tanggal 27 Desember 2021, Pemilihan Mitra Kerjasama Alat Pembacaan Strip Urin Analisa Dan Alat Pembacaan Sedimen Urin Otomatis Instalasi Laboratorium yang diselenggarakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 30 Desember 2021
Waktu : 10.00 – 11.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten (via email ulprsst2@gmail.com)
Dihadiri Oleh : 1. Tim Kerjasama Bidang Pelayanan
2. Tim Teknis
3. Kepala ULP
4. Tim KSO ULP

Berikut adalah notulen dari Acara Penjelasan Dokumen Pemilihan (Anwijzing):

- Pemberian penjelasan (*anwijzing*) dilaksanakan via email pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 10.00 WIB s/d 11.00 WIB melalui email ULP RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro (ulprsst2@gmail.com).
- Mekanismenya adalah dengan pertanyaan dikirimkan ke alamat ulprsst2@gmail.com sesuai jadwal. Pertanyaan yang masuk setelah berakhirnya jadwal pemberian penjelasan akan diabaikan.
- Pada acara tersebut terdapat pertanyaan dari 2 (Dua) Calon Mitra sebagaimana tangkapan layar berikut:

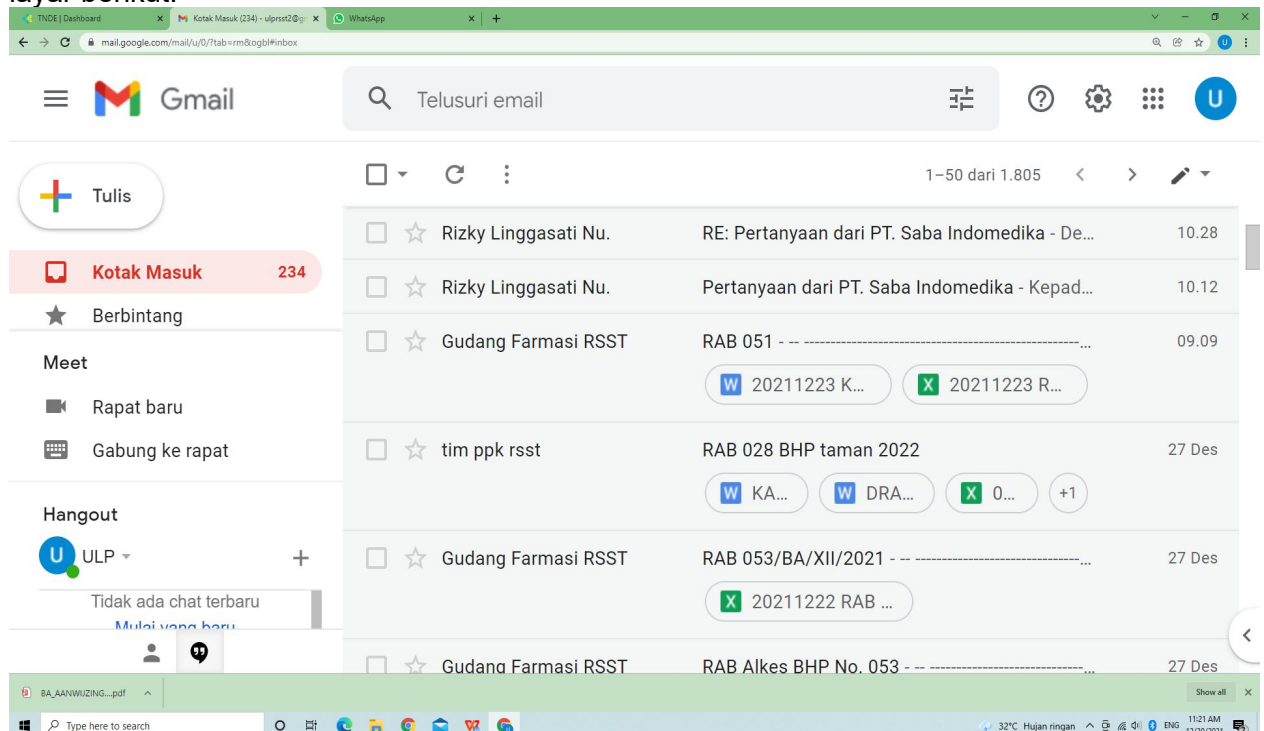

No	Nama Calon Penyedia	Pertanyaan	Jawaban
1	PT. Saba Indomedika	Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan : 1. Alat yang dikehendaki apakah system modular (urine kimia dan sedimen terintegrasi) atau dapat sendiri2? 2. Sistem pengadaan apakah system CPRR atau pembelian reagen? 3. Untuk harga apakah belum termasuk PPN? 4. Jangka waktu pelaksanaan berapa hari sampai alat selesai diinstal? Karena biasanya untuk alat baru, kami butuh waktu 90 hari dari mulai produksi.	1. Alat yang dimaksud bisa sendiri-sendiri. 2. Kerjasama ini menggunakan sistem Cost per test. 3. Harga sudah termasuk PPN. 4. Untuk masa transisi penggunaan alat baru, akan disepakati pada saat pertemuan pra kontrak.
2	PT. Saba Indomedika	Ada tambahan pertanyaan dari kami : 1. Persyaratan sertifikasi CDAKB (cara distribusi alat kesehatan yang baik) apakah sebaiknya menjadi persyaratan? 2. Jika system CPRR, maksimal duplo yang ditanggung mungkin bisa dicantumkan. 3. Untuk persyaratan pengalaman apakah perlu untuk alat sejenis yang ditawarkan, atau hanya cukup pengalaman saja?	1. Untuk sertifikat CDAKB (cara distribusi alat kesehatan yang baik) tidak kami jadikan persyaratan. 2. Akan disepakati pada saat pertemuan pra kontrak. 3. Persyaratan pengalaman untuk pekerjaan sejenis yang ditawarkan: a. Apabila menawarkan Alat Pembacaan Strip Urin Analisa, maka yang dilampirkan Kerjasama Operasional Alat Pembacaan Strip Urin Analisa. b. Apabila menawarkan Alat Pembacaan Sedimen Urin Otomatis, maka yang dilampirkan Kerjasama Operasional Alat Pembacaan Sedimen Urin Otomatis c. Apabila menawarkan keduanya, maka yang dilampirkan Kerjasama Operasional keduanya.

d. Tidak Terdapat Addendum / Perubahan Dokumen Pemilihan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimanamestinya.

Tim KSO ULP

- Turut memberikan penjelasan:
- 1. Tim Kerjasama Bidang Pelayanan
 - 2. Tim Teknis